


AUSGABE 4/2017 

PRAXIS-NEWSLETTER FÜR ALLE PEGAMED-ANWENDER

HRSGBR. BASTIAN KELLNER – JOSEF-ADLER-STR. 8 – 93049 REGENSBURG




SEHR GEEHRTE PRAXIS,

heute erhalten Sie unseren letzten Newsletter für dieses Jahr mit neuen Infos, Tipps und Tricks rund um PegaMed, EDV und Hardware. Wenn Sie den Newsletter in Zukunft per Email oder gar nicht mehr erhalten möchten, beachten Sie bitte die letzte Seite (Fax-Rückantwort). Alternativ können Sie **alle Ausgaben** des Newsletters auch aus unserem **Archiv** unter **www.bytekontrol.de** herunterladen.


AUSFÜHRLICHER TEST DER KASSENABRECHNUNG

Ihre Kassenabrechnung (KA) testen Sie regelmäßig unter Abrechnung – Kasse – Abrechnung testen. Im darauf erscheinenden Dialog sind Standardeinstellungen hinterlegt, die die KA auf grobe Fehler und generelle Einreichbarkeit bei der KV prüft (s. Abb. links). Setzen Sie jedoch extra Häkchen bei „Fehler/Warnungen lt. Kodierregelwerk“ sowie alle Häkchen unter „Hinweise“, erhalten Sie ein mächtiges „Controllingwerkzeug“, welches Ihre Abrechnung bedeutend verbessern kann (s. Abb. rechts)! Denn jetzt werden nicht nur grobe Fehler angezeigt, sondern z.B. auch Fälle, in denen Laborbudgetbefreiungsziffern,

Chronikerpauschalen, Zuschläge uvm. angesetzt werden können. Auch unsinnige Doppeldiagnosen werden hier aufgelistet: „Dem Fall sind verschiedene Codes für ... zugeordnet“ (s. Abb nächste Seite).

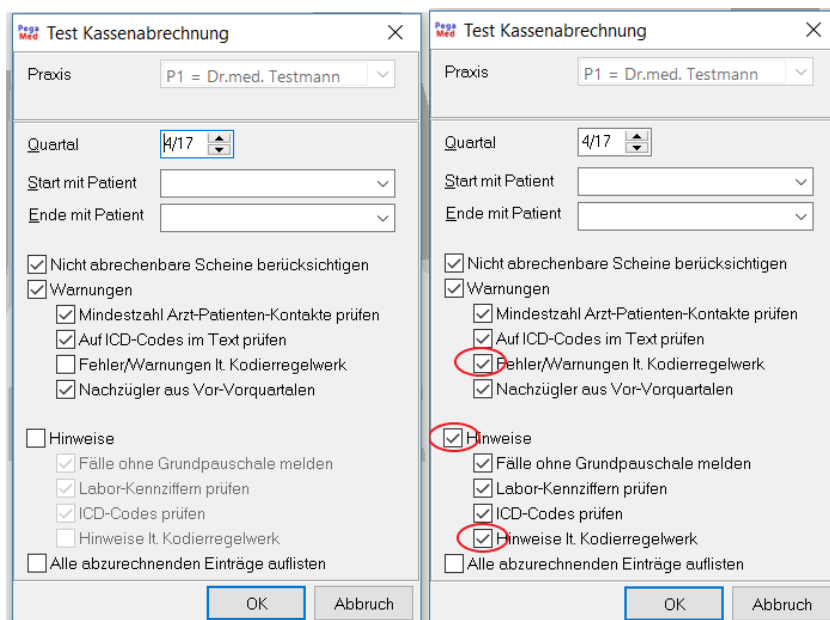

Option	Standard (links)	Geändert (rechts)
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht abrechenbare Scheine berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Warnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mindestzahl Arzt-Patienten-Kontakte prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Auf ICD-Codes im Text prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fehler/Warnungen lt. Kodierregelwerk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nachzügler aus Vor-Vorquartalen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hinweise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fälle ohne Grundpauschale melden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Labor-Kennziffern prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ICD-Codes prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hinweise lt. Kodierregelwerk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Alle abzurechnenden Einträge auflisten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

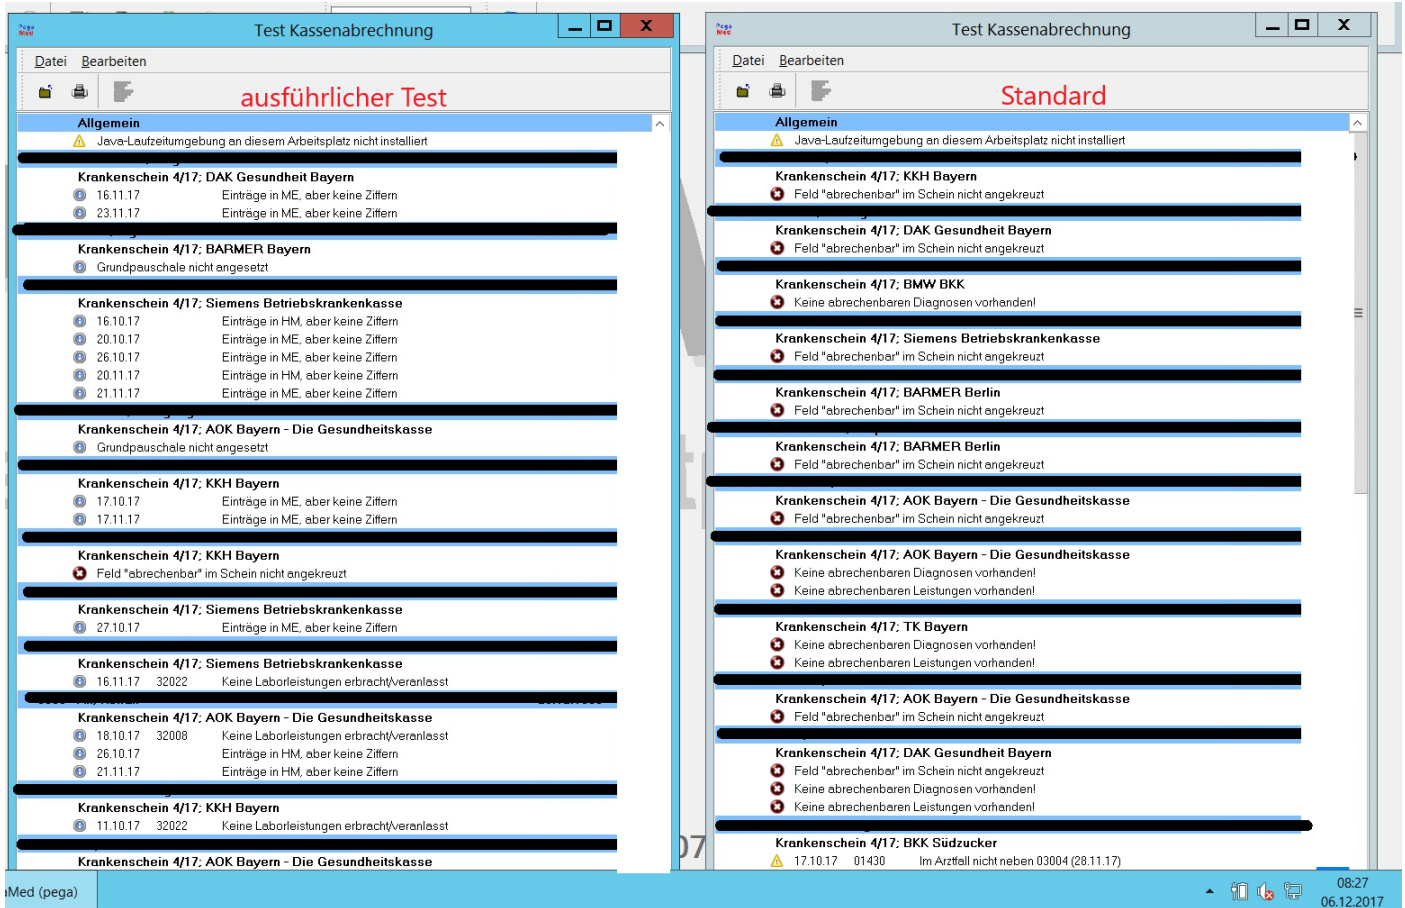


LABORWERTE SORTIEREN, BESTIMMTE WERTE SOFORT ANZEIGEN

Die Laborwerte „lernt“ PegaMed beim ersten Einlesen der Labordatei aus der Labor-DFÜ, ohne feste Reihenfolge. Sie können sich aber die Laborwerte z.B. von kleinem zu großen Blutbild sortieren und auch voreingestellte Filter anlegen, welche ganz gezielt z.B. Lipidwerte anzeigen.

Die Laborwerte sortieren Sie unter Datenbanken – Labortests – Sortieren. Markieren Sie einen einzelnen oder mehrere (indem Sie „Strg“ gedrückt halten) Werte und ziehen Sie sie mit der Maus an eine beliebige Stelle nach oben oder unten. Ggf. müssen Sie an den oberen oder unteren „Rand“ stoßen, um in der Liste weiter nach oben oder unten zu gelangen. Alternativ können Sie auch den/die markierten Wert/e mit den grünen Pfeilen rauf oder runter schieben. Zwischendurch und am Ende speichern Sie mit dem Diskettensymbol.

Einen voreingestellten Filter für z.B. Lipidwerte legen Sie über Einstellungen – Labor – Laborblatt an. Mit NEU erzeugen Sie einen neuen Filter. Geben Sie einen Namen ein und haken Sie darunter nur die Werte an, die dieser Filter anzeigen soll. Nutzen Sie unbedingt die Funktionen „Alle“, „Keine“ (damit verkürzen Sie das Häkchensetzen) und Zeitraum (damit grenzen Sie die angezeigten Werte auf z.B. 12 Monate ein). Dieser Filter erscheint nun bei allen Patienten im Laborblatt im Drop-Down-Menü alternativ zu „Alle Messwerte“. Dort können Sie auch jederzeit einen freien Filter für einen oder mehrere bestimmte Laborwerte erstellen. Dieser ist dann aber nicht immer für alle Patienten verfügbar, sondern nur einmalig!

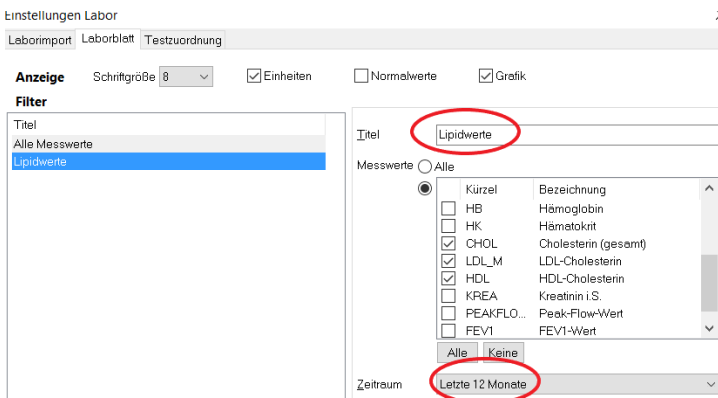


Test	Einheit	16.07.01	05.09.03	24.08.05
Cholesterin (gesamt)	mmol/l	5.86+	5.86+	5.92+
LDL-Cholesterin	mmol/l		3.63	3.86

TERMINPLANER – EINZELNE BEREICHE FARBIG ABSETZEN

Im Terminplaner können Sie wie mit einem Textmarker einzelne Bereiche farbig hinterlegen. So kann man z.B. die Zeit von 8:00 bis 10:00 komplett gelb einfärben.

Hierzu gehen Sie unter Einstellungen – Termine zu den Sperrzeiten. Dort legen Sie mit PLUS eine „Sperrzeit“ an, mit der Eigenschaft „Termine möglich“. Legen Sie einen Namen (z.B. Notfälle), die Wochentage, Uhrzeiten und die Farbe fest.

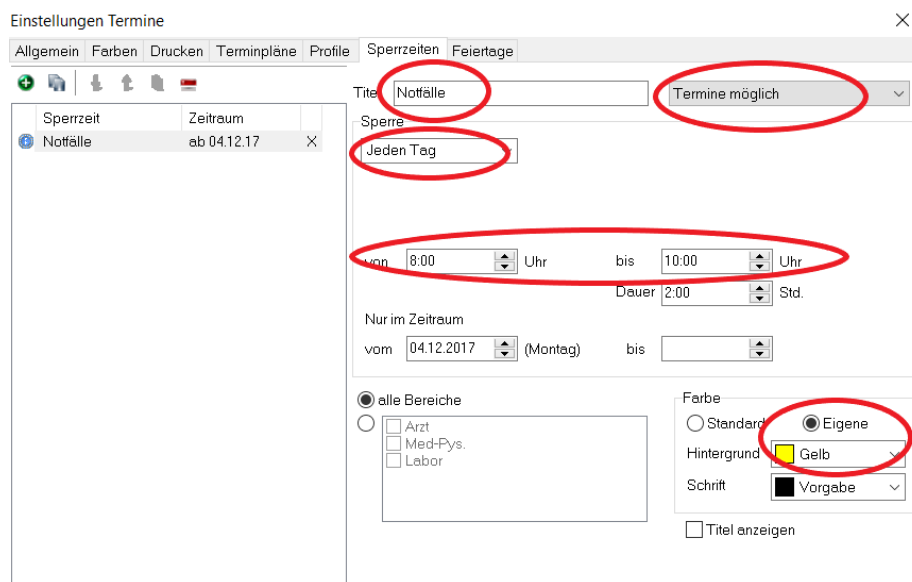

Wir hoffen, es waren auch für Sie wieder interessante Inhalte dabei. Für Fragen, Anregungen oder Kritik nutzen Sie bitte unsere Fax-Rückantwort oder senden Sie uns eine Email an buero@bytekontrol.de. Vielen Dank.

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen guten Jahreswechsel!

Mit den besten Grüßen aus Regensburg,

Bastian und Magdalena Kellner

Rechtliche Hinweise: die in diesem Newsletter dargestellten Tipps, Tricks, Produkte und Meinungen spiegeln allein die Meinung des Herausgebers wieder und nicht die der Firma Pega Elektronik GmbH bzw. deren Mitarbeiter. Sollten wir Sie mit der Art des Newsletters, der Übermittlungsform oder der darin enthaltenen Beiträge verärgern, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Die aufgezeigten Tricks und ggf. Veränderungen an Ihrem PegaMed oder Betriebssystem erfolgen auf eigene Gefahr. Wir empfehlen eine Datensicherung vor allen Änderungen. Bei Unsicherheiten dürfen Sie uns jederzeit vorab konsultieren.

FAX-RÜCKANTWORT (FAXNUMMER 0941/78036545)

- Ich möchte den Newsletter nicht weiter erhalten
- Ich möchte den Newsletter in Zukunft per Email an _____ erhalten
- Ich möchte Informationen zum Thema _____
- Ich habe folgende Frage(n)/Vorschläge/Anmerkungen

Absender: _____



BYTEKONTROL
IT SERVICE FÜR ARZTPRAXEN

So erreichen Sie uns

ByteKontrol
Bastian Kellner
Josef-Adler-Str. 8
93049 Regensburg
0941/780365 -44 (Fon), -45 (Fax)
0171/7008831 (Mobil)
info@bytekontrol.de
www.bytekontrol.de
www.pegamed.de